


Anschlussstutzen für die Probenentnahme ohne Prozessunterbrechung

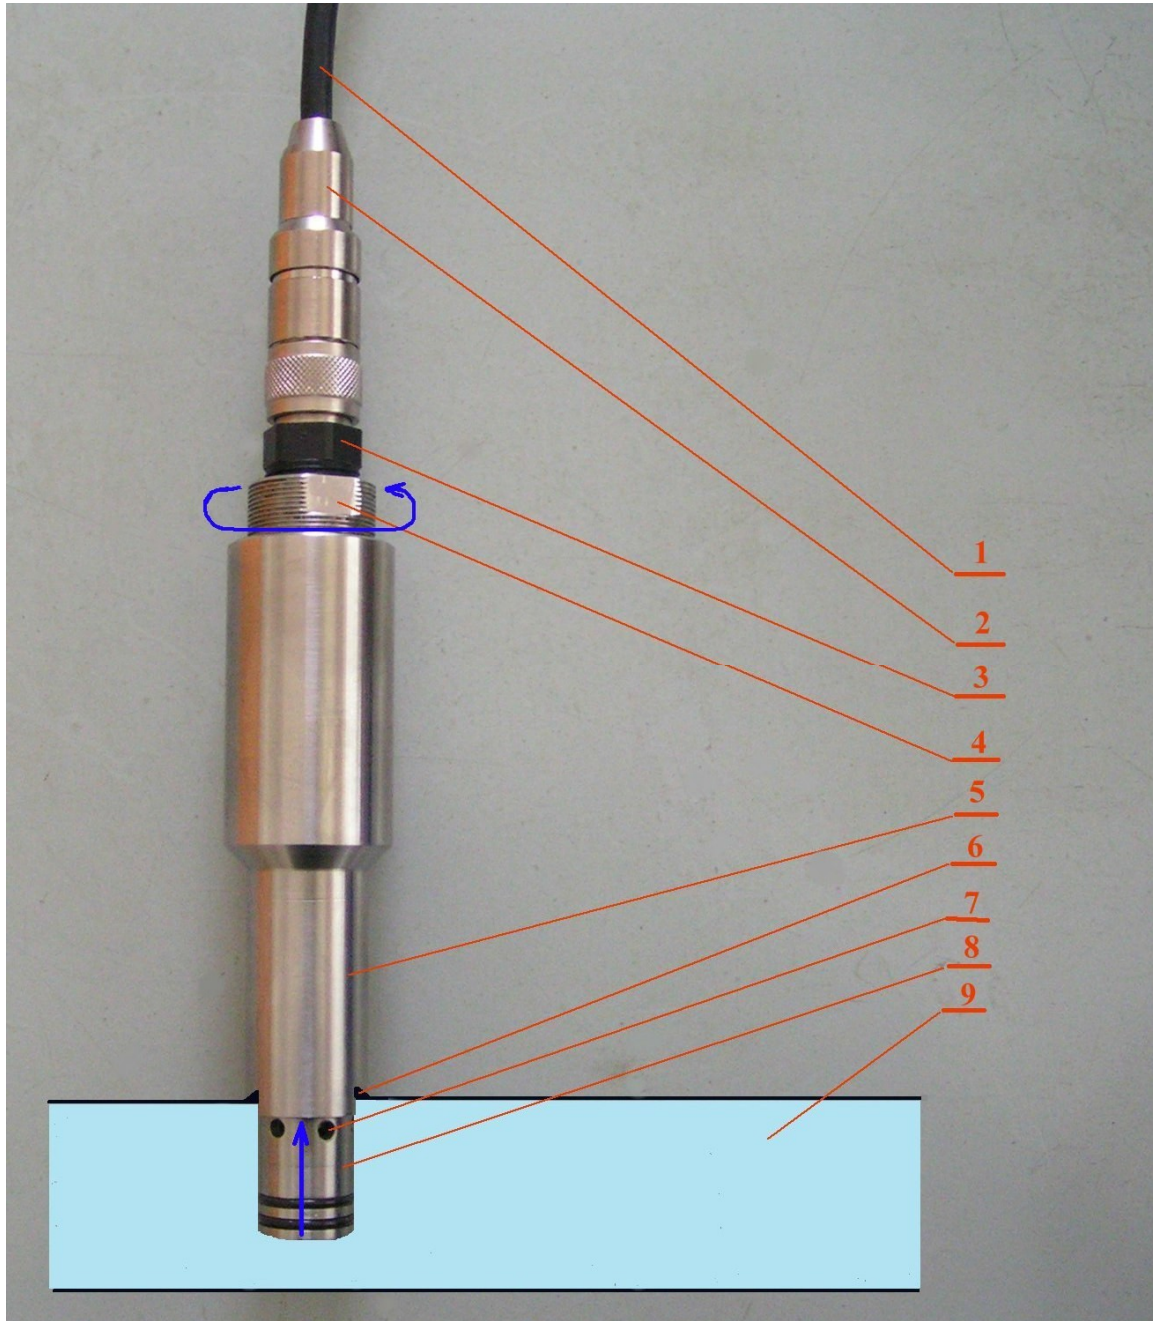

- Position 1– Kabel Sauerstoffsensord
- Position 2- Stecker Sauerstoffsensord
- Position 3- Sensord
- Position 4- Gewinde (innen)
- Position 5- Stutzen außerhalb Rohrleitung
- Position 6- Stutzen in Rohrleitung
- Position 7- Einlass Messkammer
- Position 8- Messkammer
- Position 9- Rohrleitung